

PHILIPS

Sluchátka

8000 Řada

TAE8005



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost sluchu	2
	Obecné informace	2
<hr/>		
2	Váš bezdrátový stetoskop	3
	Co je součástí příslušenství	3
	Přehled stetoskopu	4
	Přehled dokovací stanice	4
<hr/>		
3	Začínáme	5
	Připojení	5
	Vložení dodaných baterií	6
	Nabíjení stetoskopu	6
<hr/>		
4	Používání vašeho stetoskopu	7
	Automatické zapnutí/vypnutí	7
	Nastavení hlasitosti	7
	Nastavení vyvážení vlevo/vpravo	7
	Zesílení zvuku prostředí	7
	Ekvalizér (EQ)	7
	Skladování a nabíjení stetoskopu	7
<hr/>		
5	LED a zvuková indikace	8
	LED indikace	8
	Zvuková indikace	8
<hr/>		
6	Péče a údržba	8
	Čištění stetoskopu a dokovací stanice	8
	Čištění koncovek do uší	8
<hr/>		
7	Příslušenství	9
<hr/>		
8	Technické údaje	9
<hr/>		
9	Oznámení	10
	Prohlášení o shodě	10
	Soulad s EMF	10
	Likvidace starého produktu a baterie	10
<hr/>		
10	Často kladené otázky	11

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost sluchu



Nebezpečí

- Abyste předešli poškození sluchu, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečný čas poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pokyny.

- Sluchátka používejte po rozumně dlouhou dobu na rozumnou hlasitost.
- Dejte pozor, abyste nezvyšovali hlasitost s přízpůsobením vašeho sluchu.
- Nezvyšujte hlasitost tak vysoko, že nebudete slyšet okolní zvuky.
- V potenciálně nebezpečných situacích dbejte zvýšené opatrnosti nebo poslech přerušete.
- Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Používání sluchátek zakrývajících obě uši není při řízení doporučeno a v některých oblastech může být protizákonné.
- Kvůli vaší bezpečnosti se v silničním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích vyvarujte rozptylování hudbou nebo telefonními hovory.

Všeobecné informace




Upozornění


- Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem: Vždy udržujte tento produkt v suchu. Nevystavujte jej nadměrnému teplu topného zařízení nebo přímým slunečním světlem.
- Na přístroj nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Neponořujte výrobek do vody.
- Čištění produktu: Použijte mírně navlhčený semišový hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, lihoviny, čpavek nebo abrazivní látky, protože by mohly poškodit výrobek.
- Produkt nerozebírejte.
- Nepoužívejte ani neskladujte výrobek na místech, kde je teplota nižší než 0 °C (32 °F) nebo vyšší než 40 °C (104 °F), protože by mohlo dojít ke zkrácení životnosti baterie.
- Tento výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka AC/DC adaptéru, odpojovací zařízení musí být snadno ovladatelné.
- Používejte pouze dodané baterie.
- Jiné typy dobíjecích nebo alkalických baterií nelze tímto systémem nabíjet.
- Baterie (sada baterií nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Nebezpečí výbuchu! Chraňte baterie před teplem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

2 Váš bezdrátový stetoskop

Co je součástí příslušenství



*Bezdrátový stetoskop Philips



Dokovací stanice



Napájecí adaptér



3,5 mm audio kabel



Optický kabel



Adaptér RCA



*Dobíjecí lithium-polymerová baterie



Náhradní koncovky do uší




Uživatelská příručka




Stručný průvodce

Přehled stetoskopu

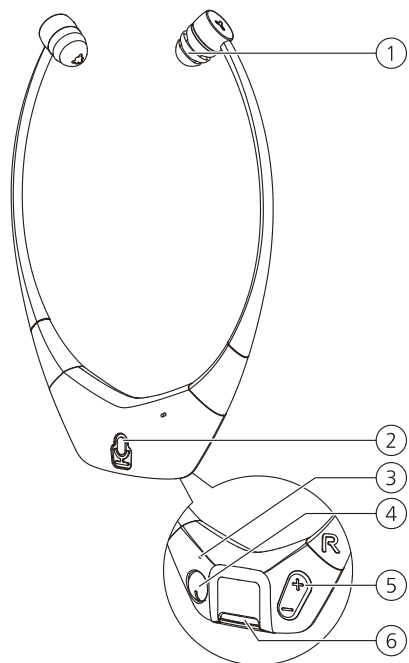

- 1, Koncovka do uší
- 2, Tlačítko bezdrátového/okolního režimu
- 3, Indikátor bezdrátového/okolního režimu
- 4, Ovládání vyvážení vlevo/vpravo
- 5, Tlačítko ovládání hlasitosti
- 6, Baterie

Přehled dokovací stanice

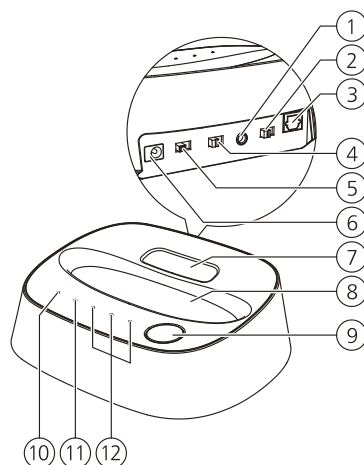

- 1, Zvukový vstup
- 2, Spínač AUDIO IN/OPTICAL IN
- 3, Optický vstup
- 4, ATT (Zeslabení spínače vstupního zvukového signálu)
- 5, POWER (zapnutí nebo vypnutí dokovací stanice)
- 6, Konektor napájecího adaptéru
- 7, Nabíjecí slot baterie
- 8, Nabíjecí slot pro stetoskop
- 9, Tlačítko ekvalizéru (EQ)
- 10, Indikátor nabíjení baterie
- 11, Indikátor nabíjení stetoskopu
- 12, Indikátory ekvalizéru (EQ)
 - EQ1: důraz na hlas
 - EQ2: zvýraznění výšek
 - EQ3: zvýraznění basů

3 Začínáme



Upozornění

- Před připojením a instalací stetoskopu si přečtete bezpečnostní pokyny v části „Důležité bezpečnostní pokyny“.

Připojení

1. Připojení zvukového zařízení




Poznámka

- Pokud je hlasitost televizoru nedostatečná, dokovací stanice se automaticky vypne.
- Napájená dokovací stanice nepřenáší při nabíjení zvukový signál.
- Najednou můžete nabit jeden stetoskop.

Podle následujících pokynů připojte zvukové zařízení a proveďte nastavení **ATT**.


Pro televizi nebo jiná zařízení s 3,5 mm zvukovým výstupem:

- Připojte jednu stranu dodaného 3,5 mm zvukového kabelu k 3,5 mm zvukovému vstupu dokovací stanice a druhou stranu k 3,5 mm zvukovému výstupu.
- přepněte na **AUDIO IN**.
- přepněte **ATT** na **0dB** (přepněte na **-8dB** pokud je hlasitost zvuku příliš vysoká).

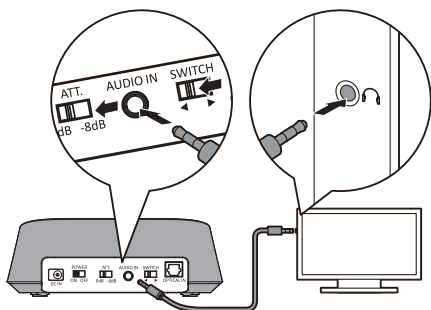


Pro TV nebo jiná zařízení s výstupem RCA:

- připojte jednu stranu dodaného adaptéru RCA k výstupu RCA zvukového zařízení a druhou stranu k dodávanému 3,5 mm zvukovému kabelu. Připojte zbývající stranu 3,5 mm zvukového kabelu k 3,5 mm zvukovému vstupu dokovací stanice.
- přepněte na **AUDIO IN** a **ATT** k **-8dB**.

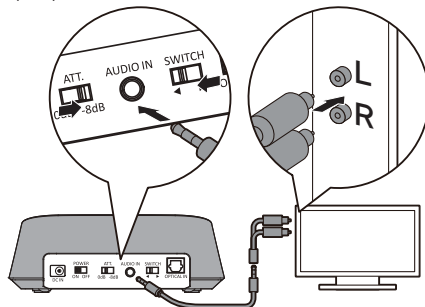

Pro TV nebo jiná zařízení s optickým výstupem:


- připojte jednu stranu dodaného optického kabelu k optickému výstupu zařízení a druhou stranu k optickému vstupu dokovací stanice.
- přepněte na **OPTICAL IN**.

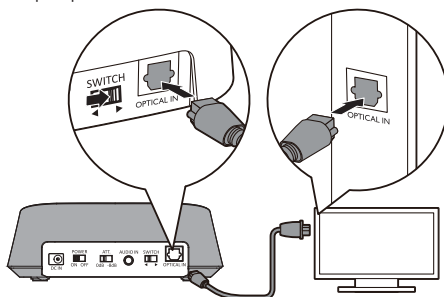

- ujistěte se, že je zvukové zařízení nastaveno na **PCM** (informace naleznete v příručce ke zvukovému zařízení).



2. Připojení napájecího adaptéru

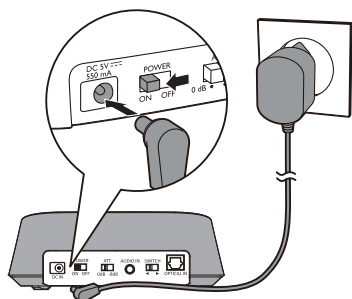


3. Nastavení hlasitosti

Upravte hlasitost zvukového zařízení tak, abyste dosáhli co nejlepší kvality zvuku (informace naleznete v příručce ke zvukovému zařízení).

Vložení dodaných baterií

První baterie

Váš stetoskop je dodáván s vysoce kvalitní dobíjecí lithium-polymerovou baterií, aby byla maximalizována životnost baterie. Vložte/vyjměte první baterii následujícím způsobem:

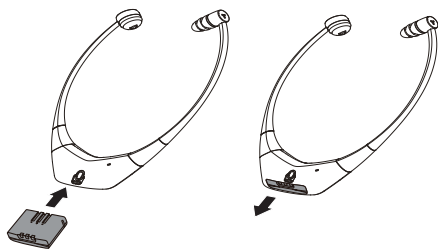


Poznámka

- Časem se kapacita baterie snižuje. Náhradní baterie si můžete objednat prostřednictvím servisních středisek Philips nebo online obchodů na adrese www.shop.philips.com

Náhradní baterie

Náhradní baterie prodlužuje provozní dobu, když je třeba první baterii znovu nabít. Vložte náhradní baterii následujícím způsobem:




Nabíjení stetoskopu



Poznámka

- Před prvním použitím stetoskopu nabijte dodanou baterii po dobu 5 hodin, aby byla zajištěna optimální kapacita a životnost baterie.
- Najednou můžete nabíjet jeden stetoskop.
- Plné nabití obvykle trvá 2,5 hodiny.


- 1 Zapněte dokovací stanici.
- 2 Umístěte stetoskop na dokovací stanici.
 - » Oranžová LED nabíjení bliká. Pokud je náhradní baterie uvnitř nabíjecího slotu, bude blikat také oranžová LED nabíjení náhradní baterie.

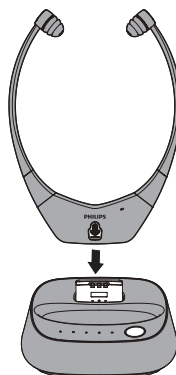

4 Používání vašeho stetoskopu

Automatické zapínání/vypínání

- Stetoskop se zapne automaticky, když jej máte na uších.
 - » LED na stetoskopu začne svítit bíle.
- Stetoskop se automaticky vypne, když si jej sundáte z uší. Tím se šetří životnost baterie.

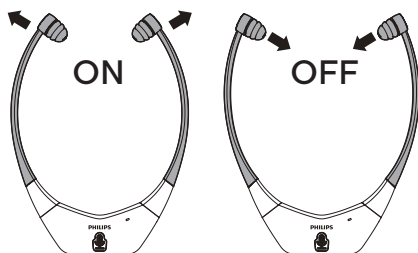

Nastavení hlasitosti


Pokud otočíte knoflíkem ovládání hlasitosti stetoskopu na maximální úroveň a hlasitost zvuku je stále nízká, můžete upravit hlasitost TV a zlepšit tak kvalitu bezdrátového přenosu zvuku (informace naleznete v příručce ke zvukovému zařízení).

Nastavení vyvážení vlevo/vpravo

Můžete nastavit vyvážení vlevo/vpravo, aby vaše obě uši dobře slyšely (viz „Přehled stetoskopu“ na straně 4).

Zesilte zvuk prostředí

Stisknutím tlačítka mikrofonu vypnete zvuk televizoru a zesílíte okolní zvuk a konverzace (viz „Přehled stetoskopu“ na straně 4).

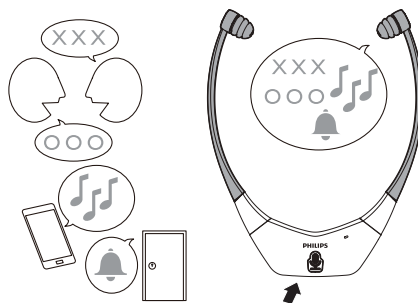

Ekvalizér (EQ)

Stisknutím tlačítka EQ můžete vybrat mezi zvýrazněním hlasu **EQ 1**, zvýraznění výšek **EQ 2**, zvýraznění basů **EQ 3** nebo vypnuto, aby stetoskop vyhovoval vašim osobním preferencím zvuku a poskytl vám tu nejlepší kvalitu zvuku (viz „Přehled stetoskopu“ na straně 4).

Skládování a nabíjení stetoskopu

Po použití umístěte stetoskop do dokovací stanice. Tím se může zabránit tomu, aby se špunty od sebe oddělily, čímž se stetoskop udrží zapnutý.

5 LED a zvuková indikace

LED indikace

Popis	Stav	LED
Baterie	Nenabíjí se	Vyp
	Nabíjení	Oranžová LED bliká.
Dokovací stanice	Nabito	Bílá
	Zap	Bílá LED bliká.
	Vyp	Vyp
	Nabíjení	Oranžová LED bliká.
	Nabito	Bílá
	Připojeno k stetoskopu	Bílá
	Vyhledávání	Bílá LED bliká.
Ekvalizér (EQ)	Zap	Bílá
	Vyp	Vyp
Stetoskop	Vyp	Vyp
	Bezdrátový režim	Bílá
	Okolní režim	Oranžová
	Připojení ztraceno	Bílá LED bliká.
	Nízká úroveň nabití baterie	Oranžová LED bliká.

Zvuková indikace

Stav	Zvukový signál
Nízká úroveň nabití baterie	1 pípnutí za minutu (po 4 minuty)
Baterie se brzy vybije.	2 pípnutí
Dosah max./min. úroveň hlasitosti.	1 pípnutí

6 Péče a údržba

Čištění stetoskopu a dokovací stanice

- 1 Ujistěte se, že je dokovací stanice odpojena od zdroje napájení.
- 2 K jemnému čištění produktu použijte mírně vlhký hadřík.

Čištění koncovek do uší

- 1 Opatrně ze stetoskopu odstraňte koncovky do uší.
- 2 Očistěte koncovky do uší teplou mýdlovou vodou.
- 3 Koncovky do uší důkladně osušte.



Poznámka

- Koncovky do uší je třeba pravidelně vyměňovat. Náhradní koncovky do uší si můžete objednat prostřednictvím servisních středisek Philips nebo online obchodu na adrese www.shop.philips.com

7 Příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství. Další příslušenství si můžete objednat prostřednictvím servisních středisek Philips nebo online obchodů na adrese www.shop.philips.com pro výměnu.



Dobíjecí lithium-polymerová baterie



Koncovky do uší

8 Technické údaje

Obecná specifikace a funkce

- Čas hudby: minimálně 5 hodin
- Čas pohotovostního režimu: až 7 000 hod
- Obvyklá doba potřebná k úplnému nabití: 2,5 hodiny
- Provozní dosah: Až 50 metrů (164 stop)
- Spínač optického vstupu/vstupu 3,5 mm
- 2,4G RF řešení
- Automatické zapnutí/vypnutí
- Zapnutí/vypnutí tlumiče
- Extra slot pro druhé nabíjení baterie
- Ekvalizér (EQ) x 3
- Frekvenční rozsah: 2 406-2 472 MHz
- Výkon vysílače: <9 dBm

Baterie

- Dobíjecí lithium-polymerová baterie (3,7 V 350 mAh)

Adaptér

- **YLJXC-O50055**, vstup: 100-240V~, 50/60 Hz, výstup: 5 Vdc 550 mA

Hmotnost a rozměry

- Stetoskop: 65 gramů
216,1 × 158,9 × 21,5 mm (V x Š x H)
- Dokovací stanice: 112 gramů
42,0 × 120,0 × 95,0 mm (V x Š x H)



Poznámka

- Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

9 Oznámení

Prohlášení o shodě

MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.p4c.philips.com.

Soulad s EMF

Tento produkt splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se vystavení elektromagnetickým polím.

Likvidace starého produktu a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být recyklovány a opětovně použity.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte produkt a baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí jednorázových baterií

Informace o vyjmutí jednorázových baterií naleznete v části „Instalace dodávaných baterií“.

Informace o životním prostředí

Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby se balení snadno rozdělilo na tři materiály: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (oddělovací část) a polyethylen (tašky, ochranná pěnová fólie.) Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud bude rozebrán specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.

10 Často kladené otázky

Neslyším žádný zvuk.

- Ujistěte se, že jste správně připojili napájecí zdroj a adaptér (viz „1. Připojení zvukového zařízení“ na straně 5).
- Ujistěte se, že jste nastavili hlasitost na odpovídající úroveň.
- Ujistěte se, že jsou baterie nabitě a správně vloženy do slotu pro nabíjení baterií (viz „Vložení dodaných baterií“ na straně 6).
- Ujistěte se, že LED na dokovací stanici svítí bíle.
- Baterie jsou vadné. Kupte si nové se stejnými specifikacemi.
- U zvukových zařízení s optickým výstupem zkontrolujte, zda je zvukové zařízení nastaveno na **PCM** (informace naleznete v příručce ke zvukovému zařízení).

Zvuk je zkreslený.

- Hlasitost je příliš vysoká. Ztlumte hlasitost.
- Stetoskop je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže k dokovací stanici.
- Stetoskop je rušen blízkými elektrickými spotřebiči. Posuňte dokovací stanici dál od nich.
- Stetoskop je na místě se silnými zdmi. Posuňte dokovací stanici dál od nich.
- Upravte **ATT** nastavení (viz „Přehled dokovací stanice“ na straně 4).
- Nastavte hlasitost zvukového zařízení.

Když pohnu hlavou, slyším rušivý zvuk.

Rušení může být způsobeno jiným bezdrátovým zařízením, jako je Bluetooth, WiFi, router nebo zařízení 2.4. Odsuňte bezdrátové zařízení pryč.

Kvalita zvuku je špatná.

- Stetoskop je mimo rozsah. Zmenšete vzdálenost mezi stetoskopem a zvukovým zařízením nebo odstraňte překážky mezi nimi.
- Upravte **ATT** nastavení (viz „Přehled dokovací stanice“ na straně 4).
- Nastavte hlasitost zvukového zařízení.

Zvuk slyším pouze v jednom uchu.

Ujistěte se, že jste nastavili vyvážení vlevo/vpravo (viz „Přehled stetoskopu“ na straně 4).

Specifikace ukazuje provozní dosah 50 metrů (164 stop). Proč je skutečný dosah kratší?

Provozní dosah je omezen překážkami jako jsou silné stěny, dveře nebo strop. Posuňte stetoskop blíže k dokovací stanici.

Další podporu najdete na www.philips.com/support.



Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.

UM_TAE8005 _10_CS _V1.0

